

セミナー プログラムのご案内

講演テーマ『包装の完全性評価について』

- ①評価手法に関する薬局方動向
- ②包装欠陥に対する漏れの理論的考察
- ③エアリークテストによる測定例と装置開発の今後



医薬包装の完全性評価に焦点をあて、ブース内でセミナーを開催します。

第18日本薬局方改正に向けた業界動向、試験の合否判定の基準である「**最大許容漏れ限度**」の設定方法、**包装の欠陥**に対する理論的な考え方や漏れのリスク評価、「**定量的漏れ試験**」が可能な検査装置の提供など、製薬メーカー各社様の課題解決のための取り組みをご紹介します。

タイムテーブル


****各テーマ15分を予定・毎日開催**

1回目	①11:00～	②11:20～	③11:40～
2回目	①13:00～	②13:20～	③13:40～
3回目	①15:00～	②15:20～	③15:40～

エアリークテスト装置
MSP-0101



ピンホール

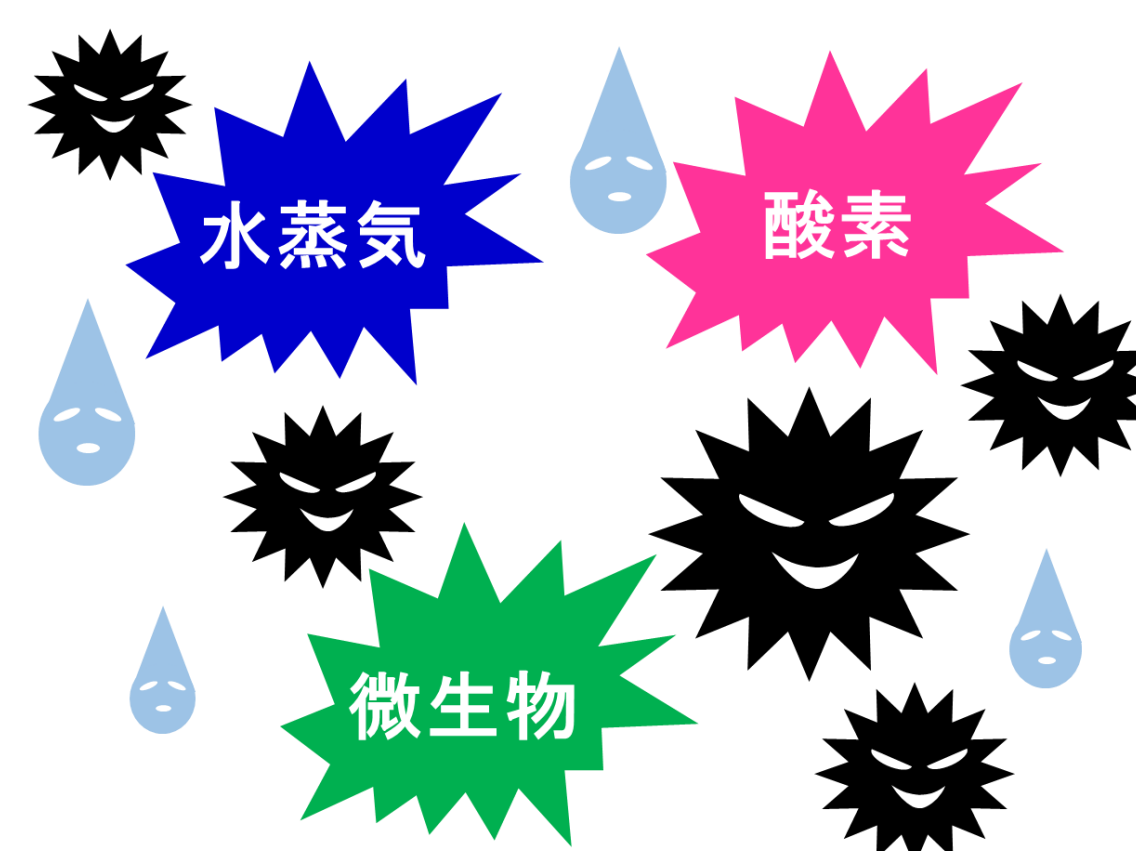

◆参加方法

会場:フクダ展示ブース内(8ホール/8F-09)

予約不要(自由参加)

※名刺交換をお願いします。

◆質問・相談・見学

ブースにて個別にご対応いたします。

ご不明点等ございましたら、お声かけください。

ホームページ

